


AUDIOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ

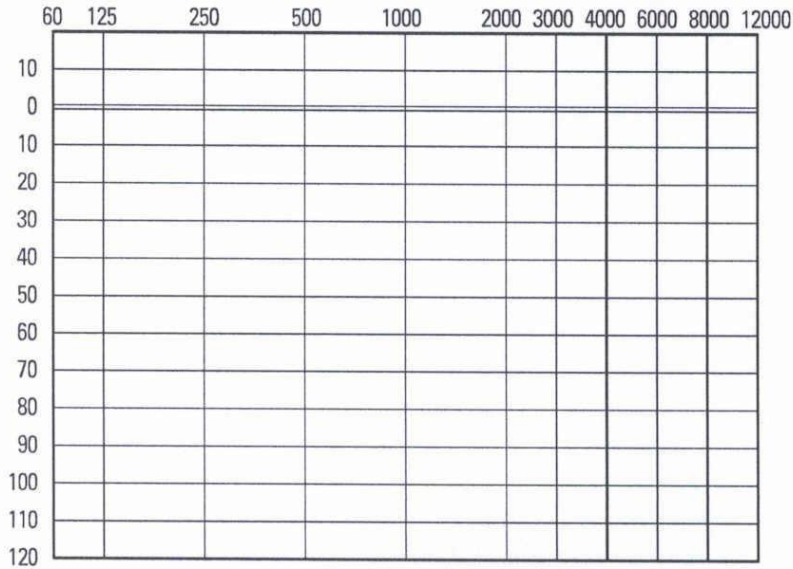

Maskování:

Srovnání hlasitosti

Ztráta sluchu v decibelech


Audiometr

SISI v %				
kHz	1	2	3	4
dx				
sin				

	Vpravo	Vlevo
Ztráta sluchu v %		
Celková ztráta v %		

vedení	vzduš.	kostní
dx	—○—	--->---
sin	—x—	---<---

SLOVNÍ AUDIOMETRIE

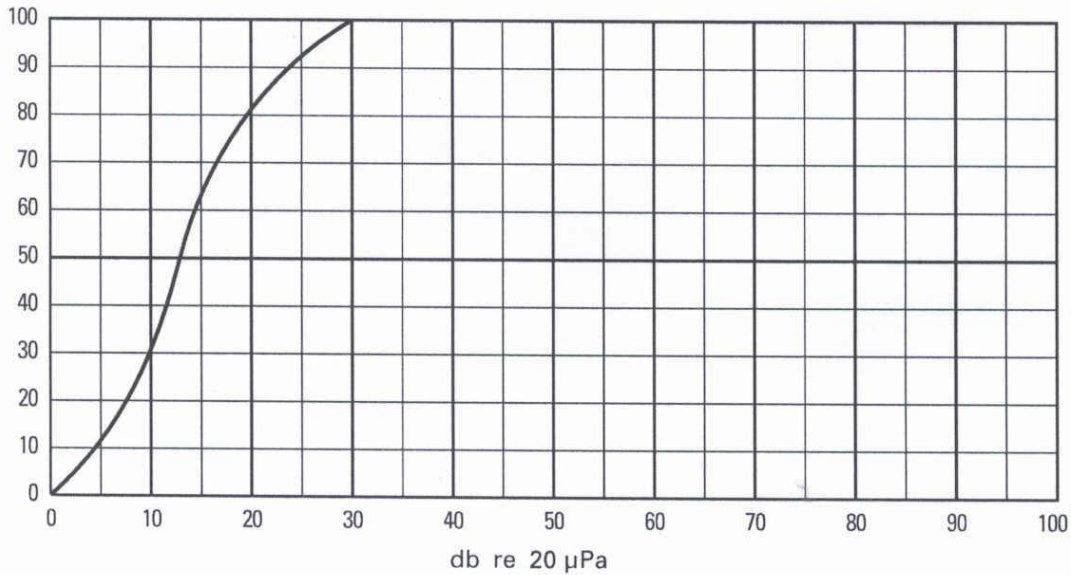

Nastavení sluchadla

Závěr: